

2015/09/04 16:50:56

測定待機中です。



試料質量 [kg]

0.999

測定時間 [秒]

1000

演算

自動演算

経過時間

1000 [秒]

測定継続

測定開始



クリア



帳票を自動印刷する

データ表示

Line Dot

試料名称

測定者名

コメント

横軸最大表示

512 1024

¹³¹I

放射能濃度 [Bq/kg]

誤差(3σ)±

-

ピーク [ch]

¹³⁴Cs

放射能濃度 [Bq/kg]

誤差(3σ)±

-

ピーク [ch]

¹³⁷Cs


放射能濃度 [Bq/kg]

誤差(3σ)±

-

ピーク [ch]

検出限界値は3.29σ

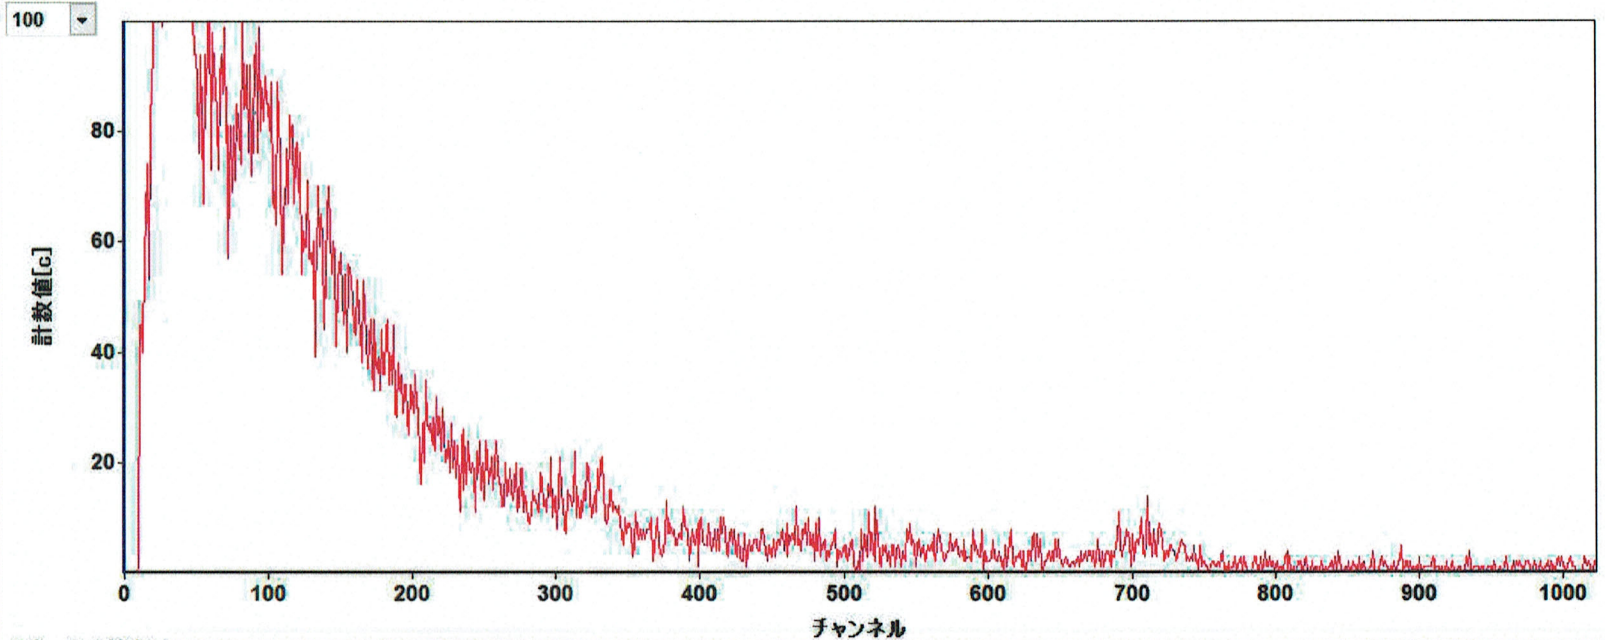

カーソル情報

0 [ch]

0 [keV]

0 [c]

